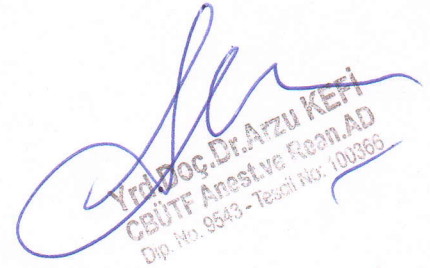


BUHAR OTOKLAV STERİLİSAZYON KİMYASAL İNDİKATÖRÜ

1. Malzeme tam sterilizasyon için gerekli olan 3 parametreyi (ısı, zaman ve doygun buhar) kontrol edecek nitelikte olmalıdır. 134 C sterilizasyonu gösterecektir.
2. İndikatör biyolojik indikatörlerle kaliteli kontrol standartlarına uygunluğu yönünden test edilmiş olmalı ve analiz sertifikası ibraz edilmelidir.
3. İndikatörün üzerinde sterilizasyon parametrelerinin kontrolünü sağlayan üç spot olmalıdır.
4. İndikatörün alt ve üst yüzeyi koruyucu film tabakası ile kaplanmış olmalıdır.
5. Her kutuda ve indikatörün üzerinde sertifikasyon no'su kayıtlı olacaktır.
6. İndikatörler lamine kaplı olmalı, mürekkep transferini önlemelidir. Her bir indikatörün üzerinde lot ve miyad yazılı olmalıdır.
7. Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
8. Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalı, normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir. Her bir paketin dışında indikatörleri dış etkilere karşı koruyacak jelatin kaplama olmalıdır.
9. Teslim edilecek ürünlerden en az 10 adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.


Yrd. Doç. Dr. Arzu KERİ
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No. 9543 - Tescil No. 100365