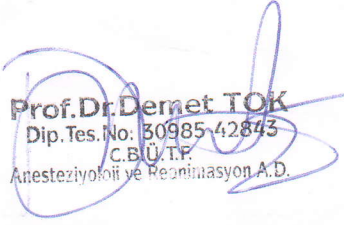


CPAP MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (NASAL)

1. Maske hastaya kolay uyum sağlayacak şekilde olmalıdır.
2. Maske CPAP uygulaması için dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Maske ile beraber kafa bandı verilmelidir.
4. Maskenin yüze değen kısmı kaliteli yumuşak silikondan yapılmış olmalıdır.
5. Maskenin iç kısmı silikon yapıda olmalıdır.
6. Maske yetişkinlerde kullanılmalıdır.
7. Maskenin boyu small,medium,large olmalıdır.
8. Maskenin üzerinde en az bir tane oksijen girişi ve ekshalasyon valfi olmalıdır.
9. Maskeler disposable ve nazal olmalıdır.
10. Maske orjinal paketinde olmalıdır.
11. Maske Üzerinde üretim yeri, lot numarası ,boyu ve referans numarası olmalıdır.
12. Maskenin hastaya uyumunu sağlamak için kafa bandı her noktadan ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
13. Maskeler istenildiği takdirde hastaneye demo yapılacaktır.
14. Teklif veren firmalar 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.


Prof. Dr. Demet TOK
Dip. Tes. No: 30985-42843
C.B.U.T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.