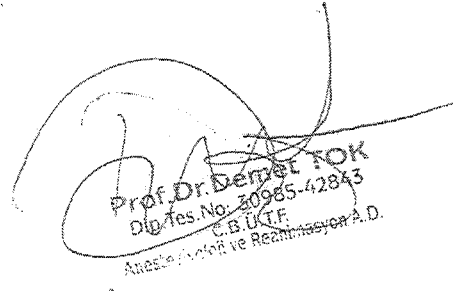


ENDOTRAKEAL TUP FIKSATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiksator, 4,5 -10 mm arasındaki tüm Endotrakeal tüp ve diğer havayolu araçlarının güvenli olarak sabitlenmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Çene anatomik yapısına uygun olmalı ve çeneye gelen kısımların tamamında baskıyı engelleyecek pedi bulunmalıdır.
3. Endotrakeal tüpün sabitlenmesi yapışkan maddeler ile değil kilitleme yapılarak sağlanmalıdır.
4. Kaymayı engelleyecek şekilde tasarlanmış tırnakları olan Sabitleme kilidi ve kilitleme mandalı bulunmalıdır.
5. Kilitleme mandalı ilerletilerek kolayca tırnaklara oturtulmalıdır.
6. Kilitleme mandalının işlem sırasında düşmesini engellemek için ana parçaya ip veya lastikli bir malzeme ile bağlı olmalıdır.
7. Kilitleme mandalının geriye gelmesini engelleyen ayrıca ikinci bir kilit mekanizması olmalıdır.
8. Kilit mekanizması kolayca sağa sola çevrilerek kilitleme tamamlanmalıdır.
9. Aspirasyon yapmayı engellememelidir.
10. Ağız içerisinde kalan kısmında ısırma bloğu olmalıdır.
11. Hastanın kafa çevresini dolaşacak uzunlukta velcro bulunmalıdır.
12. Ana parçanın hem alt hem de üst tarafında velcro nun pürüzlü olan parçası bulunmalıdır.
13. Velcro nun tüylü olan kısmının ucu, ortasından kesik olmalı ve bu kesik çekilerek istendiğinde kolayca ilerletilebilmelidir.
14. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı olmalıdır.


Prof. Dr. Demet TOK
Diy. Tes. No: 30985-42843
C.B.U.T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.