

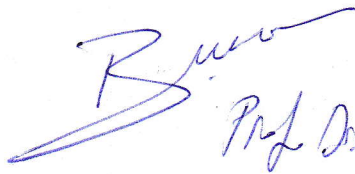
Wolke Blauer Stein Vordruck

[illegible]

3 Parçalı Antibiyotikli Şişirilebilir Penil Protez Teknik Şartnamesi

1. Penil protez vücuda uyumlu silikon materyal olmalıdır.
2. Protezin tamamı antibiyotikle (rifampin ve minocycline) kaplı olmalıdır.
3. Protez enine kontrollü genişleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Protezin yapısında silindir-pompa-rezervuar mevcut olmalıdır.
5. Protez 12 ile 28.5 cm arasında uzatma parçaları ile 0,5 cm. aralıklarla ayarlanabilir olmalıdır.
6. Ara uzunluklara ulaşmak için ikişer adet 0,5 cm. ile 6 cm. arasında ve 1,5 cm. eklenebilir uzatma parçaları olmalıdır.
7. Pompa şişirme ve söndürme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.
8. Protezin büyüklüğüne göre 65 ile 100 ml. arası rezervuar doldurulabilmelidir.
9. Ürünün kurulumu için aksesuar kiti bulunmalıdır.
10. Teklifi verilen ürünün CE belgesi olmalıdır.

- 1.Kalem = Silindir
- 2.Kalem = Aksesuar Kiti ve RTE (Arka Uçlar)
- 3.Kalem = Rezervuar


Prof. Dr. Bülent Arıntı