

NT-PROBNP (N-TERMİNAL NATRİÜRETİK PEPTİD HORMON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

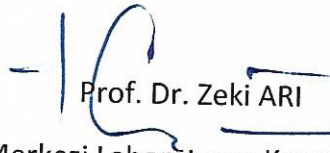
SUT KODU: 903 160

Alım miktarı: 480 test

1. Cihaz kan t p n n  zerine yerleřtirilmesinden itibaren t m ařamaları otomatik olarak kendi yapmalıdır.
2. Cihaz minimum  rnek kapasitesi 2 mikrolitre olmalıdır.
3. Kitlerin kontaminasyonunu engellemek amacıyla kullanıma hazır test kartuřları řeklinde olmalıdır.
4. Kitin ambalajı en fazla 10 testlik kartuřlar h halinde olmalıdır.
5. Cihaz  alıřılan son kontrol sonucunu hafızasında saklayabilmelidir.
6. Cihazın NT-proBNP  l  m aralıkları 20-35000 ng/L olmalıdır.
7. Cihaz EDTA'lı numune veya lityum heparinli tam kan veya plazma kullanmalıdır.
8. Cihaz immunassay teknolojisi ve time resolved florimetrik deteksiyon teknolojisi ile analiz yapmalıdır.
9. Cihaz test sonu larını kantitatif olarak rapor etmelidir.
10. Cihaz  zerindeki dokunmatik ekran  zerinden y netilebilmelidir.


Prof. Dr. Fatma TANELİ

Laboratuvar Birim Sorumlusu


Prof. Dr. Zeki ARI
Merkezi Laboratuvar Koordinat r 