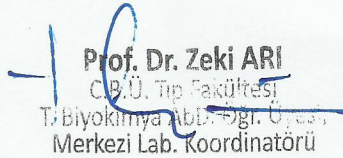
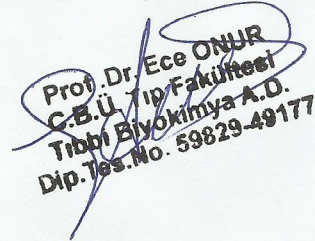


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
RIA KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	BUT Kodu	Malzeme Adı	Test Miktarı
1		Free testosteron	2000
2		17 OH progesteron	2000
		TOPLAM	4000

1. Teklif edilecek bütün kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miyadlı olmalıdır. Kitler partiler halinde ihtiyaç oldukça teslim alınacaktır. Kitler gerekirse miyadı dolmadan 3 ay önce, firmaya iade edilip, yeni miyadlılarla değiştirilebilmelidir
2. Kitler radyoimmün assay -RIA yöntemi ile ölçüm yapılmalıdır.
3. Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, dilüsyon reaktifleri ve standartlar ücretsiz olarak verilmelidir.
4. Kitler mevcut olan en küçük ambalajlarda verilmelidir.
5. Firmalar teklif ettikleri kitlerin markalarını tekliflerinde belirtecekler; kit kataloglarını teklifle birlikte vereceklerdir.
6. Kitler ilgili ihaleyi kazanan firmadan, laboratuvarımızın ihtiyacına göre partiler halinde teslim alınacaktır.
7. İhaleye giren firmalar tüm kalemlere teklif vermek zorundadır.
8. Kitler soğuk zincir kurallarına uygun olarak taşınmalı ve teslim edilmelidir.
9. RIA kitlerinin son kullanım süresi dolmadığı halde tracer son kullanım tarihinin geçmesi halinde yeni miyadlı tracer getirilmelidir. Kitler, orijinal ambalajlarında bulunmalı, üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.
10. Serum örneklerinin ayrılması, kitlerin uygulanması ve sonuçların basılması için kullanılacak olan 4000 adet 2 ml'lik ependorf tüp, RIA cihazında kullanıma uygun 10 rulo termal kağıt, bir adet masa üstü ayarlı çalar laboratuvar saati firma tarafından ücretsiz ihale sonuçlandıktan sonra 1 ay içinde laboratuvara teslim edilmelidir.


Prof. Dr. Zeki ARI
C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğr. Üyesi,
Merkezi Lab. Koordinatörü


Prof. Dr. Ece ONUR
C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No. 59829-49177