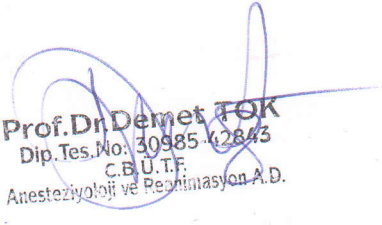


TAM YÜZ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Maske, hastanın gözlerini de içine alacak şekilde tüm yüze uygulanabilmeli ve hava kaçağı yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Yüze değen kısmı tamamen yumuşak silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Maskenin yüze değen kısmı, uygulama sırasında içine hava dolarak maskeyi yüze doğru itecek şekilde içe doğru kıvrılmış olmalıdır.
- 3) Maske non-invasiv ve invazif ventilatör cihazlarında kullanıma uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Maske ile birlikte, invazif yoğun bakım ventilatörlerinde non-invasif uygulama yapılabilmesi için, kullanıcı tarafından kolay takılıp çıkarılabilen elbow konektörü verilmelidir.
- 4) Aynı hastada; invazif ventilatörden Non- invaziv ventilatör(BPAP türü) ile uygulamaya geçmek istendiğinde, maske değişimine ihtiyaç olmadan, opsiyonel non-invasif elbow konektörü takılabilmelidir.
- 5) Maske ile istendiğinde bronkoskopi yapılabilmesi için, bronkoskopi çubuğunun girişine sahip opsiyonel elbow konektörü bulunmalıdır.
- 6) Yoğun Bakım ventilatörlerinin basınç destek(PS) ve bi-level modlarında uygulanmasında bir sınırlama olmamalıdır. Maskenin hortum girişi, ventilatör cihazlarının hasta devrelerine kolayca takılabilmelidir.
- 7) Maske üzerinde en az 1 adet oksijen giriş portu olmalıdır.
- 8) Maske, kolay çıkarılıp takılabilen başlığı ile birlikte teslim edilmelidir.
- 9) Maskeye takılan hortumun saat yönünde veya tersi yönde dönmesi sırasında hava kaçağını engellemek için, maske üzerinde bulunan elbow rotasyonu sağlayabilmelidir.
- 10) Maske çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilmesi için en az 3 farklı boya(S, L, XL) sahip olmalıdır.
- 11) Teklif ekinde teknik şartnameye uygunluk belgesi verilmelidir. Teklifte birlikte verilecek orijinal dokümanlarda, şartnameye verilen cevaplar işaretlemelidir.
- 12) Malzeme ÜTS ye kayıtlı olmalıdır.


Prof. Dr. Demet TOK
Dip. Tes. No: 30985-42843
C.B.Ü.T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.