

REASUBLE KASET

1. Kaset sistemi OERTLI marka cihaza bire bir uygun olmalıdır.
2. Kaset sistemi AUTOCLAV ile steril edilebilir olmalıdır
3. İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır.
4. Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.
5. İrrigasyon ve aspirasyon hatları ile serum seti ve damlacık odacığı, kasete üretim esnasında sabitlenmiş olmalıdır ve her hangi bir şekilde yanlış bağlantıya imkan tanımamalıdır.
6. İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır
7. Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.
8. Kaset kutusu üzerinde üretim tarihi bulunmalıdır.
9. Orjinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemeden kaynaklanan arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceğini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince aynı cihazı bırakmayı garanti ve taahhüt etmelidir. Noter tasdikli taahhütname vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Sağlık bakanlığı ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

SUT KODU: GZ1086

İsa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Hastanesi
D. ALTINİŞİK
Dip. Tesc. No: 153808

5 adet

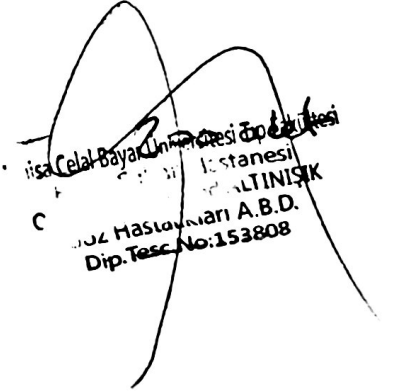
HİDROFİLİK LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lens monoblok olmalıdır.
2. İmplantasyonun kolay olabilmesi için tamamı hidrofilik akrilik materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Optik tipi bikonveks, Haptik açısı 0° olmalıdır.
4. Lens tüm üretim aşamalarını barındıran 2 boyutlu barkod sistemine sahip olmalıdır. Orijinal ürün etiketinde 2 boyutlu barkod bulunmalıdır.
5. Refraktif indeksi en az 1.46, su içeriği en az % 25 olmalıdır.
6. 5.75-6.00 mm'lik optik genişlik ve 12.00 - 12.50mm'lik haptik uzunluğu olmalıdır.
7. Lens katlanmaya hazır dizaynda olmalıdır.
8. Posterior kapsül opasifikasyonunun minimal olması için keskin kenar dizayna sahip olmalıdır veya ANTI PCO özelliği olmalıdır.
9. UV blokajı olmalıdır veya riskli hastalar için 400-550nm zararlı mavi ışığı rahatlıkla filtre etmelidir.
10. Katlanma kolaylığı açısından katlama mekanizmasının içinde katlanmaya hazır dizaynda paketlenmiş olmalıdır.
11. Yag lazere dayanıklı olmalıdır.
12. Enjektör sistemine uyumlu olmalıdır. Lens başına disposable sistem verilmelidir (1 kartuş + 1 enjektör). 2,20 - 2,80 mm aralığında kesi girişlerine uygun kartuş modelleri olmalıdır. Farklı boyuttaki kartuşlarda gerektiğinde birbiri ile değişim yapılabilmelidir.
13. Tek kullanımlık enjektör, kartuş her lens sayısına eşit ücretsiz verilmelidir lens ile birbirine tam uyumlu olmalıdır ayrıca lense özel üretilmiş olmalıdır.
14. Lens numuneleri denenecek ve ilgili hekim tarafından beğenilmeyen ürünlere uygunluk verilmeyecektir.
15. Numune için 3 adet lens gönderilecektir. 3 lens denendikten sonra uygunluk verilecektir.
16. Arka kapsülü tehdit edecek şekilde birden hızlı açılan, haptikleri optiklerine yapışan, kartuş tasarımı optimal olmadığı için haptikleri sıkışan veya kopan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.
17. Alınan lenslerin dioptrileri uygun olmadığı durumda ilgili firma istenilen uygun dioptrideki lensi 48 saat içinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
18. Lens kutusu üzerinde markası, modeli, son kullanma tarihi, optik ve haptik ölçüleri, dioptrisi, barkot numarası, lot numarası, üretim sürecini gösteren kare barkot, CE

sembolü,ISO bilgisi, steril sembolü, A sabiti, haptik açısı orijinal kutunun üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır

19. Teklif edilen malzemelerin "ÜTS" 'de onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır. Alımı yapılacak tıbbi cihazların ÜTS' de sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranmalıdır
20. Lenslerin son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihleri geçme riski olan lensler yenileri ile ücretsiz değiştirilebilmelidir.
21. Alınacak lenslerin dioptrik dağılımı alım sonrası firmaya bildirilecek ve firma istenilen dioptrileri sağlayacaktır
22. İstekli firma mümessil ve/veya ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ÜTS kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise mümessil ve/ veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı ÜTS de yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur

SUT KODU: GZ 1015


İstanbul Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Cerrahi Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tesc. No: 153808

1.IOL hidrofobik kaplı akrilik materyalinden olmalı veya %25 su içerikli yeni jenerasyon hidrofobik materyalden yapılmış olmalı veya hidrofilik akrilik materyalden olmalı ve katlanabilir özelliği olmalıdır.

3. Lens kapsül desteğinin yetersiz olduğu afak gözlerde yada travma, psödoeksfoliasyon, marfan sendromu gibi şartlarda gelişen lens subluksasyonunda, hem erişkin hem de çocuk yaş grubunda rahatlıkla kullanılabilir.

5.IOL nin optik kenar kesileri dik olmalıdır.

7. Optik genişlik ve haptik uzunluğu en az 6,0/ 13,50 mm olmalıdır.

9. Diyoptri aralığı 0 dan 35 'e kadar olmalıdır.

11.İhale sırasında istenen miktarda numune getirecek, numuneler test edilecek ve kullanıma uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.

13.Firma ilk teslim ettiği lenslerin diyoptrisinde ihtiyaca göre istenilen değişiklikleri istenilen süreler içerisinde yapmalıdır, bu durum lens stoğu tükeninceye kadar geçerli olacaktır.

13. Firma ilk teslim ettiği lenslerin üyopmesinde kırıkda g...
içerisinde yapmalıdır, bu durum lens stoğu tükeninceye kadar geçerli olacaktır.

14. Optik veya haptik hasarlarına (haptik kırılması, optik parçalanması, optik kısımda derin çizik ve çatlak oluşması vb.) ve diğer imalat hatalarında ürünü değiştirmelidir.

15. Otoklavda steril edilmiş olmalıdır. Göz içerisinde toksik materyal bulaşmaması için sterilizasyon teknolojisi buhar otoklav(steam) olmalıdır

16. Teklif edilen malzemelerin "t.c ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası" 'nda onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır. Alımı yapılacak tıbbi cihazların titubb' da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranmalıdır.

17.Sağlık bakanlığı ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

30 adet