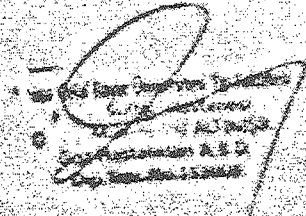


Alcon kombine kaset
Mal ID:7066
40 adet

VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERİ 23G

1. Hastanemizde bulunan Alcon marka Vitrektomi cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Bu pak ile hem ön hemde arka segment cerrahisi kaset değiştirilmeden yapılabilmelidir.
3. Pak; direct venturi sisteme uygun, venturi odacığına sahip ve aynı zamanda peristaltik drenaj pompasına da uygun kaset içermelidir.
4. Bu kaset, drenaj sensörü tarafından algılanıp, istenildiği gibi çalışması için, şeffaf ve dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Pak; 7500 kesi/dakika pnömantik radial kesi yapabilen vitrektomi probunu bünyesinde bulundurmaktadır. pak; fiberoptik illuminatör, 4 mm'lik infüzyon kanülü, 3 adet 23 gauge m.v.r. bıçak (valfli trokar seti kullanıma hazır halde), serum seti ve infüzyon hattı tubing seti, şeffaf naylon dan imal edilmiş cihaz ön panel örtüsü, otomatik üç yollu musluk, 20 cc.'lik enjektör ve yukarıda bahsedilen kasete uygun atık torbası içermelidir.
6. Pak; irrigasyon ve aspirasyon tubing bağlantıları içermelidir.
7. Irrigasyon ve aspirasyon hattı konnektörleri cihazın us hp uygun olarak yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Irrigasyon ve aspirasyon hatları farklı renklerde olmalıdır.
9. Pak içindeki atık torbası, mikrobiyolojik ve diğer laboratuvar testleri için enjektör ile örnek almaya yarayan silikon bir sisteme sahip olmalıdır.
10. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
11. Pak üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
13. Pak'in nereden güvenle açılabilceğini gösteren bir işaret bulunmalıdır
14. Pak cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
15. UBB ve ÜTS Kaydı Olmalıdır
16. Paketin içinde olan ürünler:

	Malzemenin Adı	SUT KODU	
1	Vitreoretinal Cerrahi Cihazlarına Uygun Çapta Kaset Ve Tüp Setleri 23g	GZ1086	1 Adet
2	İnfüzyon Kanülleri 23g		1 Adet
3	Pnömatik Vitrektomi Probları 23g		1 Adet
4	Endoilluminasyon Probları 23g		1 Adet
5	Vitreoretinal Trokar Sistemi 23g		3 Adet


T.C. Sağlık Bakanlığı
Gıda ve Tıbbi Ürünler Genel Müdürlüğü
İstanbul