


## PERKÜTAN PLEVRAL DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm set içeriği steril olmalıdır.
2. Setin içerisinde perkütan kateter, iğne, neşter, 60cc'lik drenaj enjektörü, 2000ml'lik boşaltılabilir drenaj torbası, uzatma hattı, sabitleme bant kiti, klemp, drenaj adaptörü bulunmalıdır.
3. Perkütan kateter en az 8 CH en çok 12 CH aralığında olmalıdır.
4. Perkütan kateter %100 radyopak poliüretan olmalıdır. X-ray'de net bir şekilde görünmelidir.
5. Perkütan kateterin üzerinde kolaylık sağlaması açısından metrik bir cetvel olmalıdır.
6. Perkütan kateterin ucundaki delik dışında uç kısmında tıkanmaların önüne geçen ve sıvı akışını kolaylaştıran üçlü delik sistemi bulunmalıdır.
7. Aynı prensip sayesinde arzu edildiğinde vücut içerisine dışarıdan sıvı enjekte edilebilmelidir.
8. Valf arzu edildiğine perkütan kateterden ayrılabilmesi ve valf ile kateter arasına uzatma hattı bağlanabilmelidir.
9. Set kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme riski taşımamalıdır.
10. Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 18 ay olmalıdır. Ulusal Bilgi Bankası'na firma ve ürünleri kayıtlı olmalıdır.
11. 2010/11 sayılı genelgeye göre tüm belgeleri olmalıdır. Ulusal Bilgi Bankası'na firma ve ürünleri kayıtlı olmalıdır.
12. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunup tıbbi cihaz yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve ürünün UBB kod numarası olmalıdır. UBB kapsamı dışında olan malzemenin kapsam dışı olduğu belgelendirilmelidir.
13. İhale sürecinde uygunluk verilecektir.

GHC 1580

Prof.Dr. Mehmet Sadık YALDIZ  
Göğüs Cerrahisi Cerrahisi ABD  
Başkanı

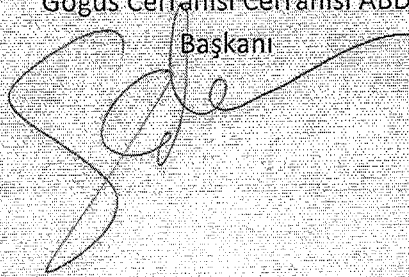

# HEIMLICH VALF TEK YÖNLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün en az 20 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Drene olan mayinin değerlendirilmesi açısından transparan (şeffaf) olmalı, iç görülebilmelidir.
3. Üzerinde akış yönünü gösterir ok işreti olmalı, hava ve sıvı ok yönünde drene olmalı kesinlikle hastaya dönüşü olmamalıdır.
4. Giriş ve çıkış kısımları silikion olmalıdır.
5. Kauçuk uzunlukları ve valve uzunlukları el ile vakum yapabilmek için ergonomi açısından en az 5 cm olmalıdır.
6. Valve kısmı vakum yapmak için elle sıkılabilir yumuşaklıkta olmalıdır.
7. Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 18 ay olmalıdır. Miadına yakın tarihli olan ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.
8. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunan tıbbi cihaz yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve ürünün UBB kod numarası olmalıdır. UBB kapsamı dışında olan malzemenin, kapsam dışı olduğunu belgelendirmelidir.
9. İhale sürecinde uygunluk verilecektir.

GHC 1830

Prof.Dr. Mehmet Sadık YALDIZ  
Göğüs Cerrahisi ABD  
Başkanı

